



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5573

LASER[®]

Thermomètre de test électronique
-50 < +200°C

Instructions



www.lasertools.co.uk

Thermomètre de test électronique -50 < +200°C

Avant toute utilisation :

retirez le couvercle de la pile et retirez la bande isolante du compartiment de la pile

Quand l'affichage devient faible, remplacez la pile

Après chaque utilisation, nettoyez la sonde et remettez en place le plastique pour éviter une contamination croisée.

Spécifications

Plage de mesures	-50 °C à 200 °C	-58 °F à 392 °F
Précision	+/- 1°C	Entre -50 °C et 100 °C
	à +/- 2,5 °C	
	+/- 2 °F	Entre -58 °F et 212 °F
	à +/- 5 °F	
Résolution d'écran	+/- 0.1	Entre -19,9 et 199°
	à 1°	
Taux d'échantillonnage	1 sec	
Pile	AAA - 1,5 volt	Fournie
Taille de l'écran	36 mm (l) x 16 mm (h)	
Taille de la sonde	200mm	totale
Longueur du cordon de la sonde	1m	
Dimensions de l'article	65 x 97 x 20mm	

Instructions

A Mesures

- Faites pénétrer la sonde d'environ 25 mm dans la substance à tester
- Faites la lecture une fois la stabilisation atteinte


B Centigrade ou Fahrenheit

- Appuyez sur le bouton °C/°F une fois pour sélectionner

C Fonction mémoire maximum/minimum

Appuyez sur le bouton Max/Min une fois pour afficher la valeur maximum.

Appuyez sur Max/Min une fois de plus pour afficher la valeur minimum.
Appuyez sur le bouton Max/Min encore une fois pour revenir à l'écran normal.

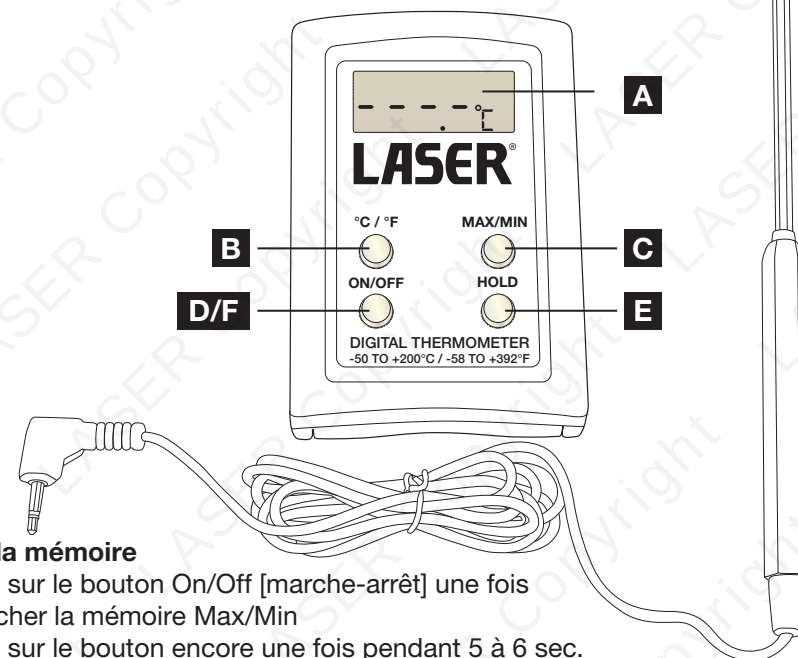

D Effacer la mémoire

Appuyez sur le bouton On/Off [marche-arrêt] une fois pour afficher la mémoire Max/Min

E

Appuyez sur le bouton encore une fois pendant 5 à 6 sec. pour effacer la mémoire

Conserver les données

Appuyez sur le bouton Hold [maintien] une fois – l'affichage va conserver la valeur lue. Appuyez sur le bouton Hold [maintien] encore une fois – l'affichage va revenir au normal

F Bouton On/Off [mise en marche/arrêt]

Appuyez sur le bouton On/Off [mise en marche/arrêt] une fois.

Le thermomètre va s'éteindre automatiquement dans environ 10 minutes.

LASER[®]

Digital Thermometer

-50 < +200°C

Instructions



- Digital thermometer for checking air conditioning performance and other uses
- Stainless Steel probe 110 x 3.8mm
- Measuring range -50 < +200°C
- Max | min memory functions
- Magnetic pad for mounting the thermometer
- CE and RoHS approved



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

TOOL CONNECTION
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Digital Thermometer -50 < +200°C

Before use:

Remove the battery cover and pull out the insulation strip in the battery compartment

Please note:

When the display becomes dim, change the battery

After each use clean the probe and replace plastic cap to avoid cross contamination

Specification

Measurement Range	-50°C to 200°C	-58°F to 392°F
Accuracy	+/- 1°C	Between - 50°C to 100°C
	Otherwise +/- 2.5°C	
	+/- 2°F	Between - 58°F to 212°F
	Otherwise +/- 5 °F	
Display Resolution	+/- 0.1	Between - 19.9 to 199°
	Otherwise 1°	
Sampling Rate	1sec	
Battery	1.5V AAA x 1	Supplied
Display Size	36mm (w) x 16mm (h)	
Probe Size	200mm	Overall
Probe Cord Length	1m	
Product Size	65 x 97 x 20mm	

Instructions

A Measurement

- Insert probe into test substance about 25mm
- Take the reading when stable

B Centigrade or Fahrenheit


- Press the °C/°F button once to select

C Maximum/Minimum Memory Function

Press Max/Min button once to display maximum reading

Press Max/Min once more to show the minimum reading

Press Max/Min button again to return to normal display

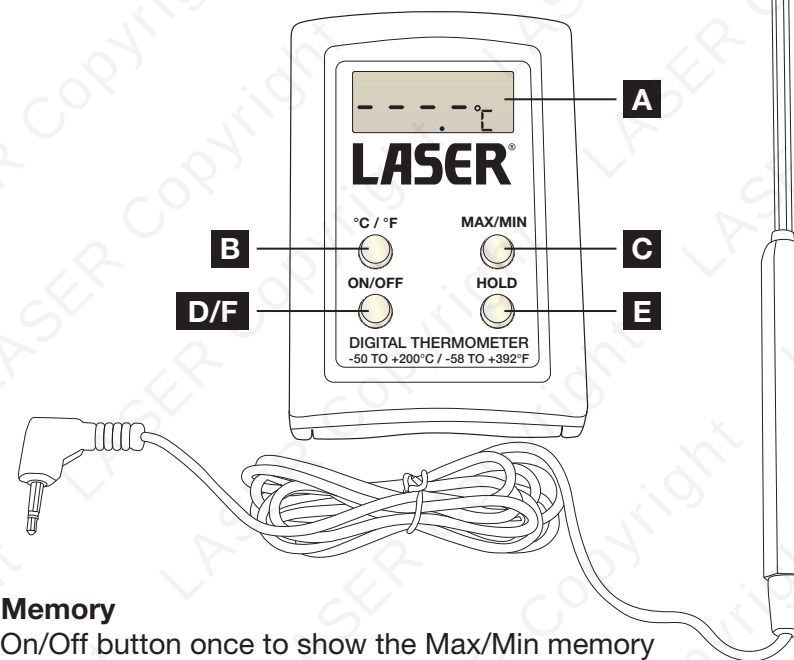

D Clear Memory

Press On/Off button once to show the Max/Min memory
Press the button again for 5-6 secs. to clear memory

E Data Hold

Press Hold button once - the display will retain the reading
Press Hold button again - the display will return to normal

F Power On/Off

Press On/Off button once.

The thermometer will power off automatically after approximately 10mins



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5573

LASER®

Elektronisches Prüfthermometer

-50 < +200°C

Anweisungen



www.lasertools.co.uk

Elektronisches Prüfthermometer -50 < +200°C

Vor dem Gebrauch:

Öffnen Sie den Batteriedeckel und entfernen Sie den Isolierstreifen aus dem Batteriefach

Sobald die Displayanzeige schwächer wird, wechseln Sie die Batterie

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Fühler und ersetzen Sie die Kunststoffkappe, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden

Technische Daten

Messbereich	-50°C to 200°C	58°F bis 392°F
Messgenauigkeit	+/- 1°C	Zwischen -50°C und 100°C
	Andernfalls +/- 2,5°C	
	+/- 2°F	Zwischen -58°F und 212°F
	Andernfalls +/- 5 °F	
Displayauflösung	+/- 0.1	Zwischen -19.9 und 199°
Abtastrate	1 Sek.	
Batterie	1.5 Volt AAA x 1	Mitgeliefert
Displaygröße	36mm (w) x 16mm (h)	
Fühlergröße	200mm	Insgesamt
Länge des Fühlerkabels	1m	
Produktgröße	65 x 97 x 20mm	

Anweisungen

A Messen


- Führen Sie den Fühler etwa 25 mm tief in die Testsubstanz ein
- Lesen Sie den Wert ab, sobald er konstant ist

B Grad Celsius oder Fahrenheit

- Betätigen Sie zum Umschalten einmalig den °C/°F-Knopf

C Memory-Funktion zum Speichern der Minimal-/Maximalwerte

Drücken Sie zum Anzeigen des Maximalwerts den Max/Min-Knopf ein Mal
Drücken Sie zum Anzeigen des Minimalwerts den Max/Min-Knopf zwei Mal
Ein weiteres Betätigen des Max/Min-Knopfes führt Sie zur normalen Displayanzeige zurück

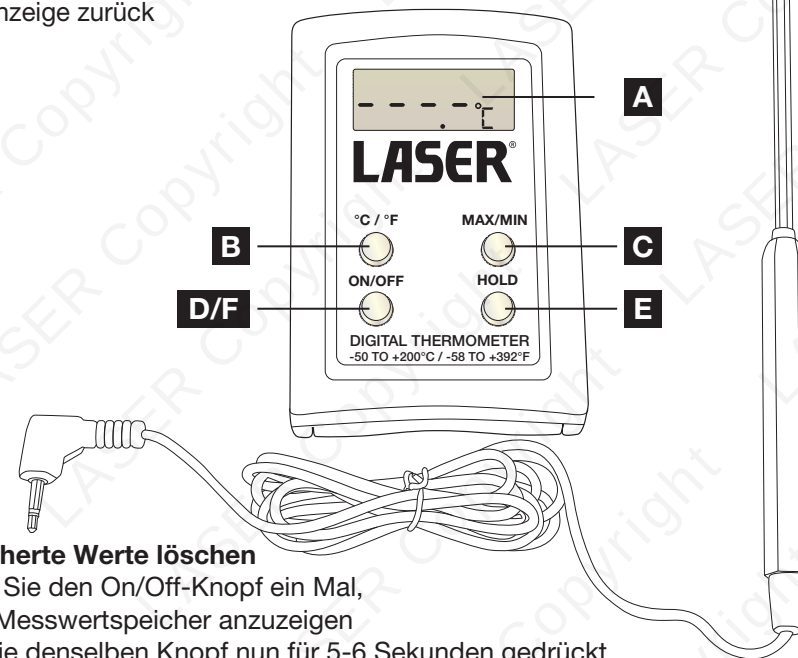

D Gespeicherte Werte löschen

Drücken Sie den On/Off-Knopf ein Mal, um den Messwertspeicher anzuzeigen
Halten Sie denselben Knopf nun für 5-6 Sekunden gedrückt, um den Speicher zu löschen

E Messwerte angezeigt lassen

Drücken Sie den Hold-Knopf ein Mal -
In der Anzeige wird der Messwert angezeigt
Drücken Sie den Hold-Knopf erneut -
Die Anzeige wechselt wieder in den Normalzustand

F An-/Ausschalten

Drücken Sie ein Mal den On/Off-Knopf.
Nach etwa 10 Minuten schaltet sich das Thermometer automatisch aus.



Safety First. Be Protected.



Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

**TOOL
CONNECTION**
The Complete Connection

Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 **F** +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



5573

LASER[®]

Termómetro de prueba electrónico
-50 < +200°C

Instrucciones



www.lasertools.co.uk

Termómetro de prueba electrónico -50 < +200°C

Antes de usarlo:

Retire la tapa de la pila y tire de la cinta de aislamiento que se encuentra en el compartimento de la pila

Cuando se atenúe la pantalla, cambie la pila

Tras cada uso, limpie la sonda y vuelva a colocar el tapón de plástico para evitar la contaminación entre líquidos

Especificaciones

Intervalo de medición	-50 °C a 200 °C	-58 °F a 392 °F
Precisión	+/- 1°C	Entre -50 °C y 100 °C
	De lo contrario, +/-2,5 °C	
	+/- 2 °F	Entre -58 °F y 212 °F
	De lo contrario, +/- 5 °F	
Resolución de la pantalla	+/- 0.1	Entre -19,9 y 199°
Frecuencia de muestreo	1 seg.	
Pila	1 x AAA de 1,5 voltios	Suministrada
Tamaño de la pantalla	36 mm (an.) x 16 mm (al.)	
Tamaño de la sonda	200mm	General
Longitud del cable de la sonda	1m	
Tamaño del producto	65 x 97 x 20mm	

Instrucciones

A Medición

- Introduzca la sonda unos 25 mm en la sustancia cuya temperatura desee medir
- Anote la temperatura cuando se estabilice

B Grados centígrados o Fahrenheit


- Pulse una vez el botón °C/°F para seleccionar la opción

C Función de memoria máxima/mínima

Pulse una vez el botón Max/Min para que se muestre la lectura máxima

Pulse el botón Max/Min otra vez para que se muestre la lectura mínima

Pulse de nuevo el botón Max/Min para volver a la pantalla normal

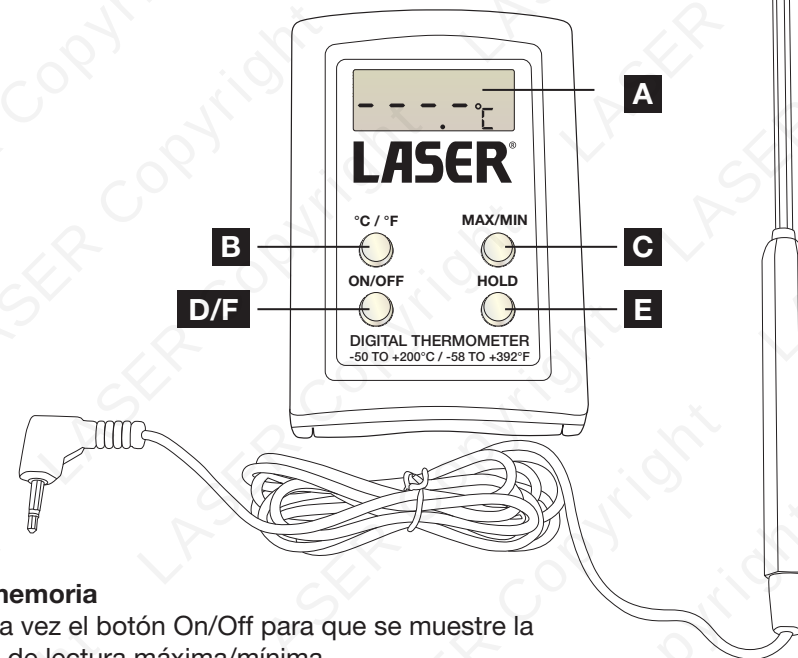

D Borrar memoria

Pulse una vez el botón On/Off para que se muestre la memoria de lectura máxima/mínima

Mantenga pulsado el botón durante 5-6 segundos para borrar la memoria

E Retención de datos

Pulse una vez el botón Hold: la pantalla retendrá la lectura

Vuelva a pulsar el botón Hold: la pantalla volverá a su estado normal

F Encendido/Apagado

Pulse una vez el botón On/Off

El termómetro se apagará automáticamente transcurridos unos 10 minutos